
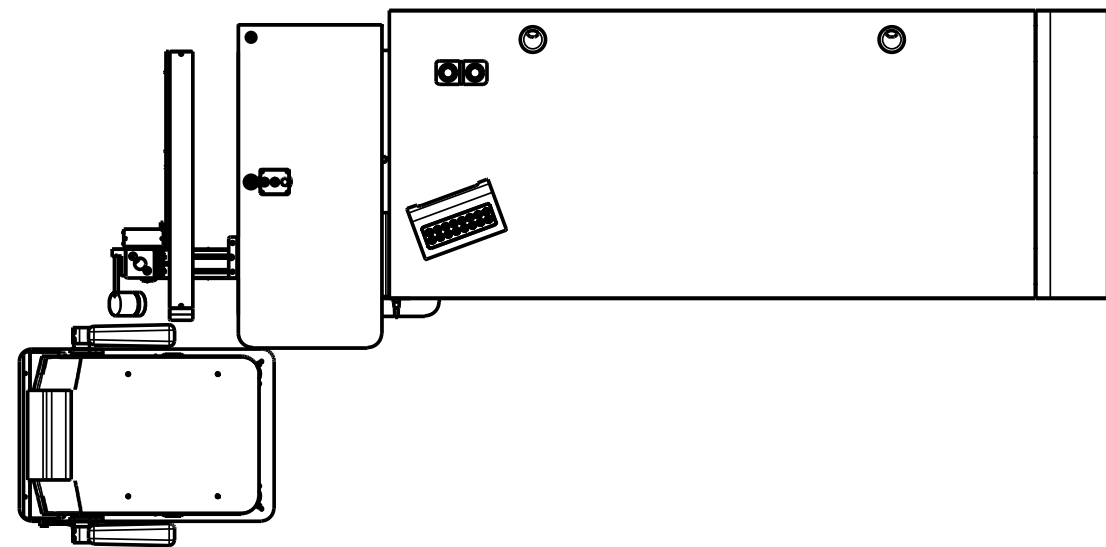
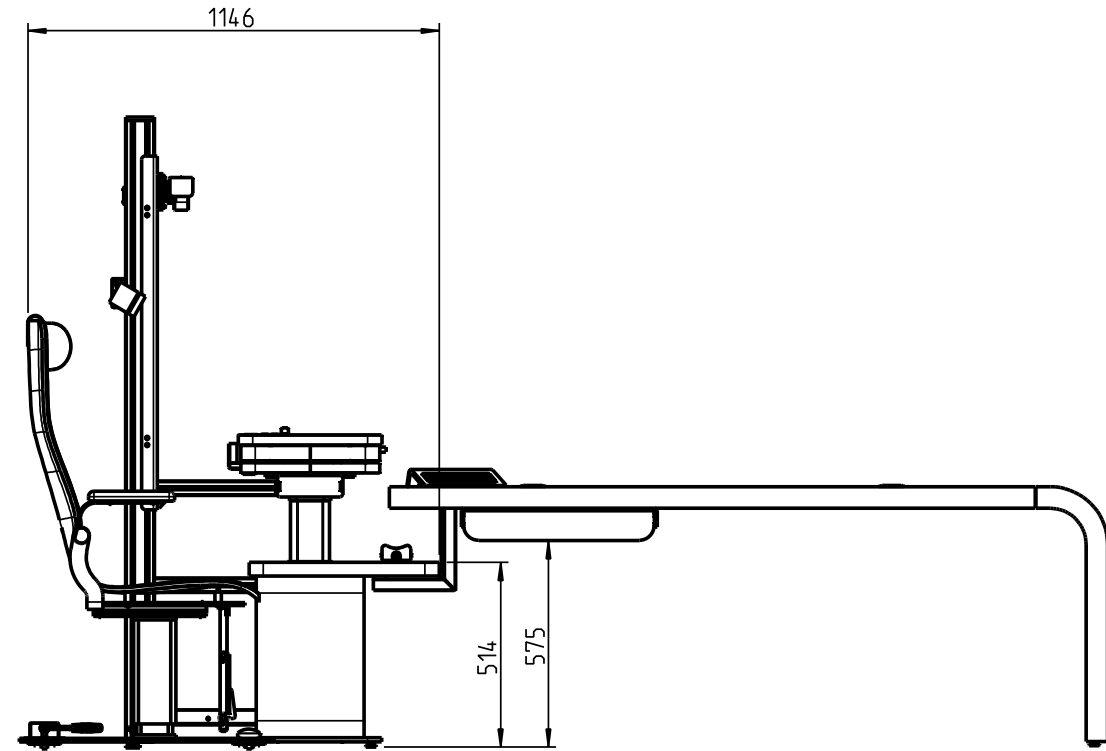
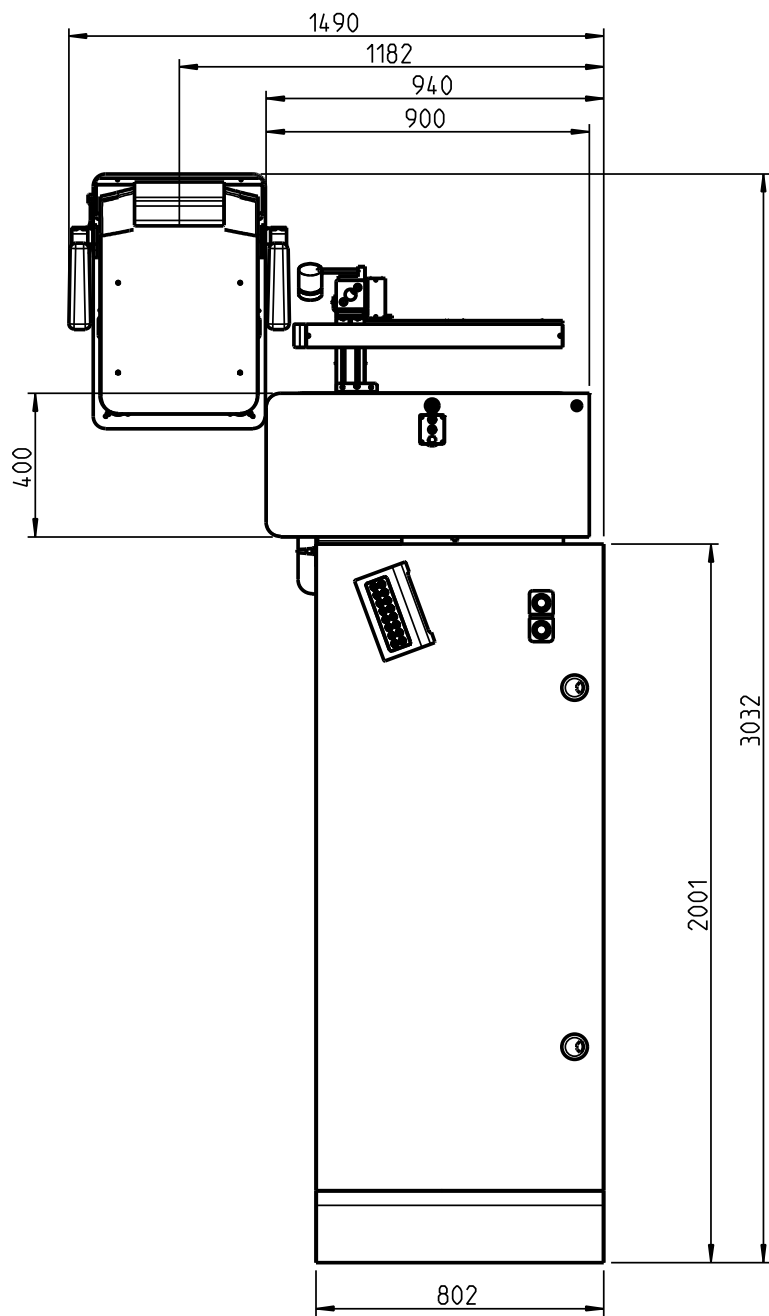


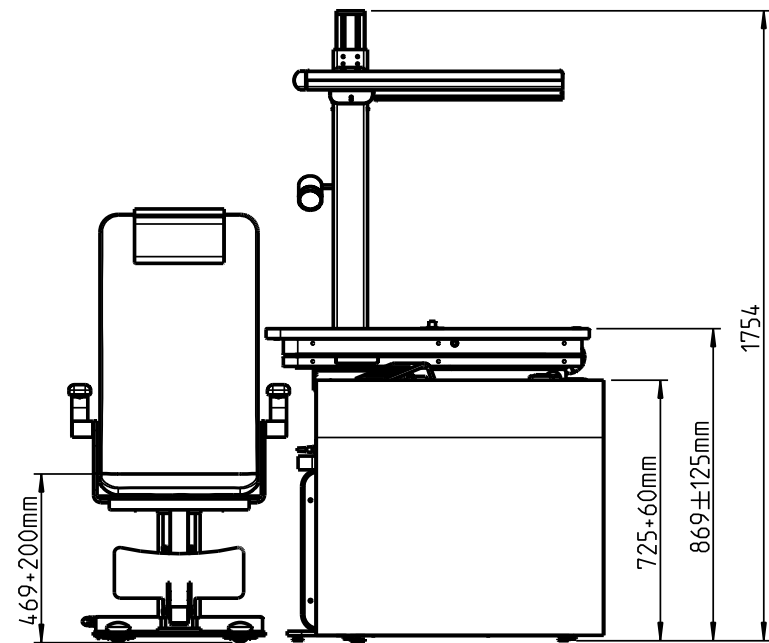

Oberflächenbehandlung		Werkstoff		+0,50 +0,05 DIN 6784		-0,50 -0,05		Oberfläche DIN ISO 1302 Ra	
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768m		Masse		Technologie/ Herstellungsverfahren		Maßstab 7:100		Formel A2	
	Datum	Name		Benennung		Änderung		Datum	
Bearb.	26.01.2016	Guder		refraction unit cubeEVO					
Gepr.									
Techn.									
GS									
Norm				Projekt					
W&G Medical				Dokumenten-Nr.		Dok.-Art		Teil-Dok.	
				2015-008-001/01				001	
								01	
						Bl		1	
						von		4	

Diese Unterlage darf nur mit unserer Genehmigung vervielfältigt, verändert oder weitergegeben werden.

Modellname: 2015-008-001_01-001